Électrode annulaire dPt



6.00403.300

Manuel d'utilisation du capteur

8.0109.8009FR / 2020-08-31

Metrohm

Metrohm AG
Ionenstrasse
CH-9100 Herisau
Suisse
Téléphone : +41 71 353 85 85
Fax : +41 71 353 89 01
info@metrohm.com
www.metrohm.com

Électrode annulaire dPt

6.00403.300

Manuel d'utilisation du capteur

8.0109.8009FR /
2020-08-31

Technical Communication
Metrohm AG
CH-9100 Herisau
techcom@metrohm.com

La présente documentation est protégée par les droits d'auteur. Tous droits réservés.

La présente documentation a été élaborée avec le plus grand soin. Cependant, des erreurs ne peuvent être totalement exclues. Veuillez communiquer vos remarques à ce sujet directement à l'adresse citée ci-dessus.

Table des matières

1 Aperçu 1

1.1 Électrode annulaire dPt – Description du produit 1

1.2 Électrode annulaire dPt – Aperçu 1

2 Description fonctionnelle 2

2.1 Électrode annulaire dPt – Description fonctionnelle 2

3 Transport et stockage 3

3.1 Électrode – Contrôler la livraison 3

3.2 Électrode – Conserver l'emballage 3

3.3 Déballer et vérifier l'électrode 3

3.4 Conserver la Électrode annulaire dPt 4

4 Installation 6

4.1 Préparer la Électrode annulaire dPt 6

4.2 Montage de l'électrode 7

5 Maintenance 9

5.1 Électrode annulaire dPt – Remplacer / faire le plein d'électrolyte 9

5.2 Vérifier l' Électrode annulaire dPt 9

6 Dépannage 11

7 Électrode – Mise au rebut 12

8 Spécifications techniques 13

8.1 Conditions ambiantes 13

8.2 Électrode annulaire dPt – Caractéristiques 13

8.3 Électrode annulaire dPt – Boîtier 13

8.4 Électrode annulaire dPt – Spécifications des connecteurs 13

8.5 Électrode annulaire dPt – Spécifications de l'affichage .. 14

8.6 Électrode annulaire dPt – Spécifications de mesure 14

1 Aperçu

1.1 Électrode annulaire dPt – Description du produit

La Électrode annulaire dPt est une électrode de métal combinée destinée aux titrages rédox avec changement de la valeur pH.

1.2 Électrode annulaire dPt – Aperçu

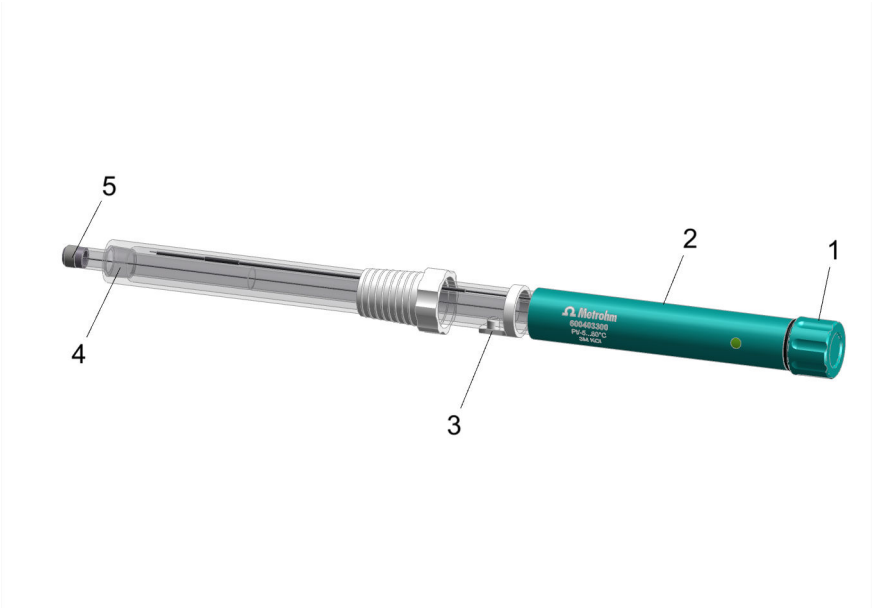


Figure 1 Électrode annulaire dPt

1	**Capuchon protecteur**	**2**	**Tête de l'électrode**
3	**Orifice de remplissage**	**4**	**Diaphragme**
5	**Anneau en métal**		

2 Description fonctionnelle

2.1 Électrode annulaire dPt – Description fonctionnelle

Les électrodes de métal Pt sont dotées d'une surface de métal polie exposée à la solution.

Au cas où la solution d'échantillon contiendrait des ions rédox actifs, il se formera à la surface de la solution Pt un potentiel dépendant de la concentration.

Cet équilibre dépendant de la concentration est caractérisé par un potentiel correspondant (potentiel Galvani).

3 Transport et stockage

3.1 Électrode – Contrôler la livraison

Contrôlez l'absence d'avaries sur la marchandise dès réception de celle-ci.

3.2 Électrode – Conserver l'emballage

Le produit est livré dans un emballage spécial particulièrement protecteur. Conservez cet emballage parce qu'il est le seul à garantir un transport en toute sécurité du produit.

3.3 Déballer et vérifier l'électrode

1 Déballer l'électrode

Déballer l'électrode avec le récipient de conservation.

2 Enlever le récipient de conservation

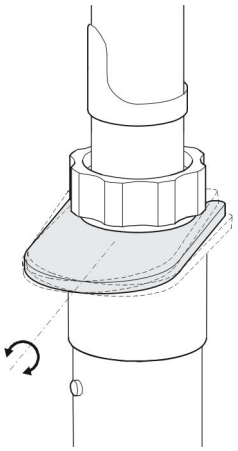


Figure 2 Séparer l'électrode du récipient de conservation

- D'une main, saisir l'électrode et le récipient de conservation de manière à ne pas laisser glisser l'électrode.
- Positionner l'outil entre le récipient de conservation et la douille de rodage.
- Basculer l'outil avec **prudence** sur le côté jusqu'à ce que l'électrode se détache.
  Ne pas basculer l'outil en avant !

REMARQUE

Éviter une pression excessive sur l'outil. L'électrode pourrait sinon se détacher de manière trop brusque.

3 **Vérifier le fonctionnement de l'électrode**

- **Préparer l'électrode :**
  Préparer la Électrode annulaire dPt (voir Chapitre 4.1, page 6)
- **Vérifier l'électrode :**
  Vérifier l' Électrode annulaire dPt (voir Chapitre 5.2, page 9)

REMARQUE

Les électrodes défectueuses doivent être retournées dans les deux mois (suivant la date de livraison) pour contrôler si la garantie est applicable.

3.4 Conserver la Électrode annulaire dPt

Afin de protéger la tête de l'électrode de l'eau, de solvants, de la poussière et des influences mécaniques, elle doit être conservée de la manière suivante :

1 Visser le capuchon protecteur *(1-**1**)* sur la tête de l'électrode *(1-**2**)*.

2 Conserver l'électrode dans le récipient de conservation. Il importe de s'assurer que le diaphragme *(1-**4**)* immerge dans la solution de conservation correspondante.

REMARQUE

Nous recommandons l'utilisation de l'électrolyte de référence comme solution de conservation.

3 Fermer l'orifice de remplissage *(1-**3**)*.

REMARQUE

Conserver l'électrode toujours immergée dans la solution de conservation.

4 Installation

4.1 Préparer la Électrode annulaire dPt

1 Faire l'appoint d'électrolyte de référence

Enlever l'obturateur de l'orifice de remplissage *(1-**3**)* et, si nécessaire, faire l'appoint d'électrolyte de référence jusqu'à hauteur de l'orifice de remplissage.

2 Nettoyer l'électrode

- Rincer l'électrode à l'eau distillée.
- Si l'anneau en métal est très encrassé, le nettoyer avec un papier essuie-tout humidifié, du dentifrice ou un jeu de polissage (6.2802.000).
- Si nécessaire, dégraisser l'électrode avec un solvant correspondant.

REMARQUE

Il est conseillé de rincer l'électrode avant chaque mesure.

Un nettoyage abrasif fréquent n'est pas recommandé.

3 Raccorder l'électrode

- Dévisser le capuchon protecteur *(1-**1**)*.
- Positionner le connecteur de câble sur la tête de l'électrode afin que la fente dans le connecteur de câble se situe sur l'ergot de la tête de l'électrode.
- Insérer la prise dans le connecteur de câble dans la fiche à l'intérieur de la tête de l'électrode.
- Coulisser l'anneau extérieur du connecteur de câble au-dessus de la tête de l'électrode.
  S'assurer que les ergots de guidage dans la tête de l'électrode se trouvent dans les rainures du connecteur de câble.
- Coulisser le connecteur de câble sur la tête de l'électrode jusqu'à la butée et tourner l'anneau extérieur jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

REMARQUE

Pour déconnecter le câble, desserrer dans un premier temps l'anneau extérieur puis retirer avec prudence le connecteur de câble hors de la tête de l'électrode

tout en veillant à ne pas tirer sur le câble, mais sur le connecteur du câble.

4.2 Montage de l'électrode



L'électrode doit être bien fixée dans la tête de titrage.

REMARQUE

Dans les processus automatiques, veiller à un jeu suffisant des câbles.

Pendant le titrage, il est important que la solution soit bien mélangée. La vitesse d'agitation doit être assez rapide pour qu'un petit « entonnoir de mélange » se forme. Si la vitesse d'agitation est trop élevée, des bulles d'air sont aspirées. Celles-ci peuvent fausser les valeurs mesurées. Une vitesse d'agitation trop faible entraîne un mélange lent de la solution et une augmentation en conséquence du temps de réponse ou du temps de titrage.

Afin de pouvoir effectuer la mesure après l'ajout de solution de titrage dans une solution bien mélangée, la pointe de burette doit être positionnée à un endroit de forte turbulence. Par ailleurs, le passage de l'ajout de solution de titrage vers l'électrode doit être le plus large possible. Il faut donc tenir compte de la direction d'agitation (sens inverse des aiguilles d'une montre ou sens des aiguilles d'une montre) lors du positionnement de l'électrode et de la pointe de burette.

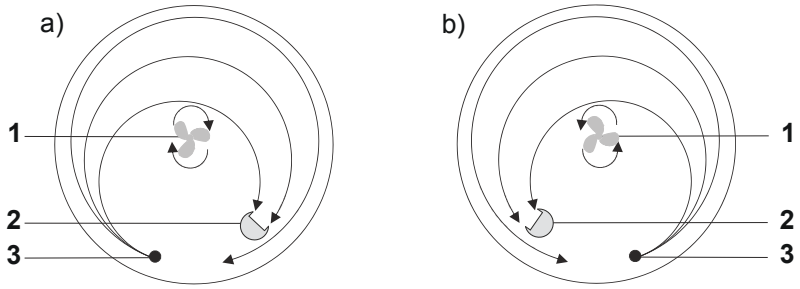


Figure 3 Schéma de disposition de l'agitateur à hélice, de l'électrode et de la pointe de burette lors d'un titrage. a) Direction d'agitation dans le sens des aiguilles d'une montre, b) Direction d'agitation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

1	**Agitateur à hélice**	**2**	**Électrode**
3	**Pointe de burette**		

5 Maintenance

5.1 Électrode annulaire dPt – Remplacer / faire le plein d'électrolyte

1. Ouvrir l'orifice de remplissage .
2. Vider l'électrode à l'aide de la pipette en plastique.
3. Rincer l'intérieur de l'électrode avec de l'électrolyte neuf.
4. Remplir l’électrode d'électrolyte jusqu’à l’orifice de remplissage.
5. Obturer l'orifice de remplissage si l'électrode n'est pas utilisée immédiatement.
6. Conserver l'électrode immergée dans la solution d'électrolyte pendant la nuit.

   L'électrode peut ensuite être à nouveau utilisée.

5.2 Vérifier l'Électrode annulaire dPt

Vérifier l'électrode sur la base du standard rédox (6.2306.020)

1. Tempérer le standard rédox dans un bain d'eau à une température de 20 °C.
2. Mesurer, en agitant, le potentiel du standard rédox.

   Si le résultat de mesure est de + 250 mV(± 5 mV) à 20 °C, alors la vérification de l'électrode a été fructueuse.

REMARQUE

Si le résultat de mesure ne correspond pas aux données mesurées, nettoyer l'électrode et réitérer le test.

Consulter le tableau ci-dessous pour plus de données mesurées concernant le standard rédox :


Tableau 1 Données mesurées pour le standard rédox (6.2306.020) en fonction de la température

Temp. (°C)	**10**	**20**	**25**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**
mV ± 5	+ 265	+ 250	+ 243	+ 236	+ 221	+ 207	+ 183	+ 178

6 Dépannage

Problème	Cause	Remède
Potentiel erroné	*Les graisses et les huiles occasionnent la formation d'une couche isolante sur l'électrode.*	Nettoyer l'électrode avec un solvant.
Temps de réponse long	*Les graisses et les huiles occasionnent la formation d'une couche isolante sur l'électrode.*	Nettoyer l'électrode avec un solvant.
	Si vous utilisez des solutions rédox faiblement tamponnées, (p. ex. oxydes), il y a possibilité d'absorption d'ions à la surface de l'électrode.	Prétraitement abrasif, oxydatif (dans le cas de solutions oxydantes) ou réducteur (dans le cas de solutions réductrices).

7 Électrode – Mise au rebut



Ce produit est soumis à la directive européenne DEEE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

L'élimination correcte de votre ancien équipement permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé.

Pour la mise au rebut de l'électrode, procédez comme suit :

1 Vider l'électrolyte

Vider l'électrolyte de l'électrode à l'aide d'une pipette en plastique.

2 Éliminer l'électrolyte

Éliminer l'électrolyte conformément aux dispositions locales.

3 Mettre au rebut l'électrode

Recycler l'électrode dans les déchets électroniques.

Pour des informations plus précises concernant l'élimination de votre ancien produit, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales, d'un centre de service d'élimination des déchets ou de votre distributeur.

8 Spécifications techniques

8.1 Conditions ambiantes

Gamme nominale de fonctionnement	+5 à +45 °C	à une humidité relative de l'air de 80 % max., sans condensation
Stockage	+5 à +45 °C	

8.2 Électrode annulaire dPt – Caractéristiques

Dimensions

Diamètre de la tige	12 mm
Longueur de montage maximale	125 mm

8.3 Électrode annulaire dPt – Boîtier

Matériaux

Matériau de tige	Verre

8.4 Électrode annulaire dPt – Spécifications des connecteurs

Connecteur	Tête enfichable Metrohm Q

8.5 Électrode annulaire dPt – Spécifications de l'affichage

Affichage de l'état	DEL	vert-rouge

8.6 Électrode annulaire dPt – Spécifications de mesure

Gamme de pH	0 à 14
Gamme de température	-5 à 80 °C
Profondeur d'immersion minimale	20 mm