

PILS-IC-VA 联用技术 气溶胶化学成分分析系统



自动连续测量气溶胶中的重金属、阴阳离子

分析化学智库™

 **Metrohm**
瑞士万通中国

随着大气污染的加剧，气溶胶（颗粒物）化学成分监测愈发的重要，特别 PM 2.5 已成为焦点问题。但传统的过滤膜采样方式存在费时、费力，采集的样品需要人工前处理，通常的采样周期为数天，无法为快速变化的大气污染提供时间分辨率更高的监测。

瑞士万通推出的气溶胶化学成分分析技术，第一次实现了气溶胶中阴阳离子、重金属的同时自动测量。其中阴阳离子的检测由离子色谱完成、而重金属的检测由 VA 完成。

气溶胶化学成分分析系统即 Particle-Into-Liquid-Sampler 是一种新颖的将大气中气溶胶（颗粒物）捕获并溶解为液体样品的技术。大气样品的

捕获过程与样品的测量过程具有响应时间短，时效性好的特点。将原过滤膜方法需要数天的采样周期缩短到数分钟。大大提高大气样品的时间分辨率，同时也大大降低分析工作中的人工工作量。


大气样品通过气溶胶化学成分分析系统之前，先通过旋风分离器，简单地去掉粒径大于预设值的颗粒物，剩余大气样品进入气溶胶化学成分分析系统。

气溶胶化学成分分析系统可以广泛地应用于大气中气溶胶（颗粒物）的污染物含量的监测，其配置灵活多变，可以适应不同研究需求，如有机酸、以及其它阴离子的监测。


大气样品的采样原理

大气样品大致可以分为颗粒状态、蒸汽态、气态样品。研究大气中气溶胶（颗粒物）的来源、形成机制、混合状态、传输过程中的物理化学行为，化学组成的变化等是气溶胶研究中常涉及到的问题。快速、有效测量气溶胶成分则是研究上述问题的基础。

气溶胶化学成分分析系统最初由美国佐治亚理工大学研发，后经由 Metrohm 重新进行工业化设计。其工作原理如右图：

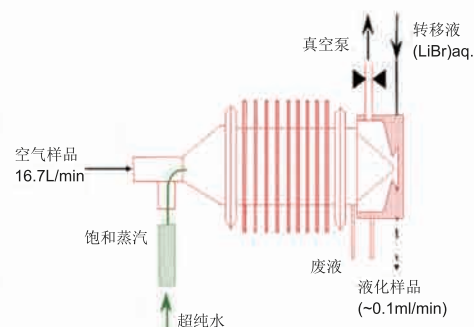


由真空泵将大气样品按 16.7 升 /min 的流量吸入混合腔，空气样品中的颗粒物与由超纯水加热而成的过饱和水蒸气、饱和水蒸气相遇。颗粒物粒子作为结晶冷核，与周围的水蒸气相结合，形成液滴，并移动中变大。如右图：

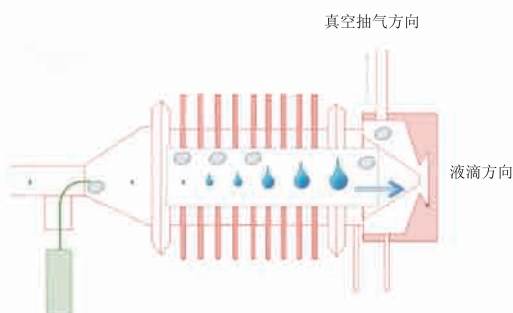


大气样品、水蒸汽与形成的液滴在混合腔内做直线运动，气流在撞击窗前急剧转向，由于液滴质量较高，仍然保持原来的直线运动方向而撞到撞击窗上，撞击到窗上并被转移液吸收。

为了便于测量，转移液中含有已知浓度的内标物，内标物的离子或分子应该是气溶胶中不含有的成分。一般情况下会使用溴化钾作为内标物。此时分析仪器可以直接分析液化样品中可溶性物质。

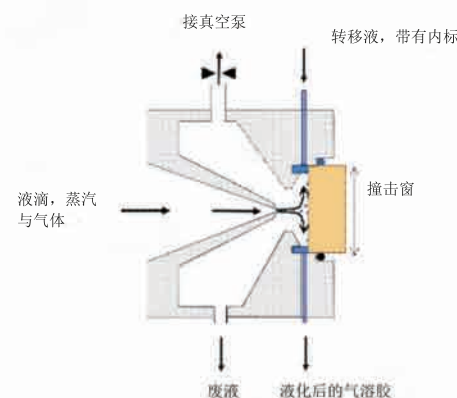


液化后的样品由蠕动泵，依次带入阴阳离子色谱的六通取样阀，取样体积 250 μ L。样品流路再经过 VA 的六通阀，其取样体积为 2mL。采样过程、样品流路的输送、VA 的测量调度、阴阳离子色谱测量以及每次测量完成后系统的清洗等都是在强大

而灵活的 MagIC 软件统一控制下完成，VA 的测量结果也自动送交 MagIC 统一处理，并给出统一的报告。这就使得不同仪器组成有机的分析系统，并不间断地自动运行。

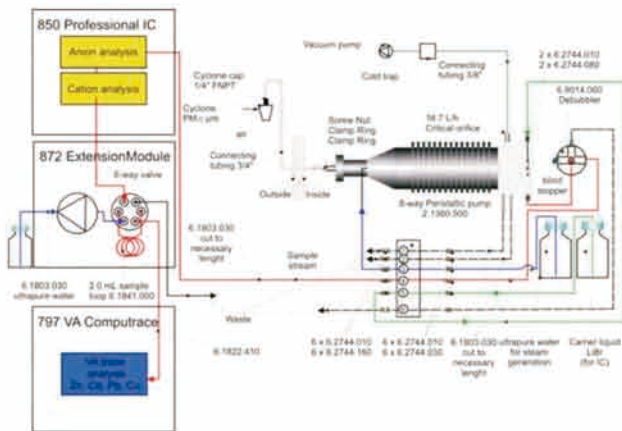

运行控制系统示意图

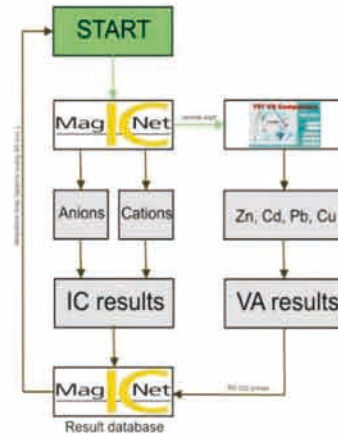

气溶胶化学成分的分析

气溶胶的阴阳离子的分析是通过离子色谱测量完成的。而重金属的分析是通过 VA 测量完成的。

测量系统包括 PILS 采样器、940IC、797VA。




它可以根
料研与调查

PO_4^{2-} 、 HPO_4^{2-}
 Pb^{2+} 、 Cu^{2+}

更换检测器

例如 ICP/
测。更切
本系统也

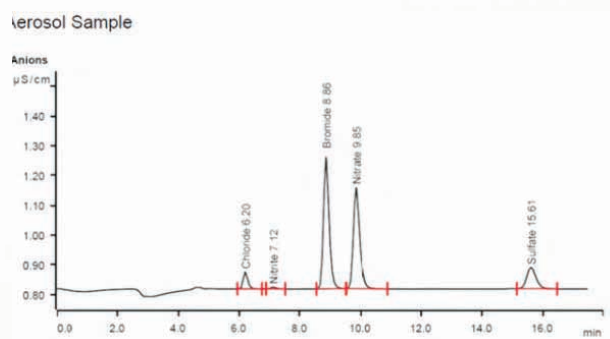

它可以根
据研究与调查

它可以根
料研与调查

PO_4^{2-} 、 HPO_4^{2-}
 Pb^{2+} 、 Cu^{2+}

它可以根
料研与调查
 PO_4^{2-} 、 HPO_4^{2-}
 Pb^{2+} 、 Cu^{2+}
更换检测器

它可以根
据科研与调查
需要，检测
 PO_4^{2-} 、 HPO_4^{2-}
 Pb^{2+} 、 Cu^{2+}
等元素，并
可更换检测器
进行检测，
例如 ICP/
AAS 系统。
更换切
割系统也

- 它可以根
科研与调查
 PO_4^{2-} 、 HPO_4^{2-}
 Pb^{2+} 、 Cu^{2+}
更换检测器
例如 ICP/
测。更换切
本系统也

Metrohm
瑞士万通中国

网址: <http://www.metrohm.com.cn>
<http://www.metrohm.com>
 电邮: marketing@metrohm.com.cn

 微信二维码

香港Hong Kong
香港太古坊华兰路20号
华兰中心806-808室
电话:+852 29676552
传真:+852 29670443

1.pils.5(1214)