


dPt 링 전극

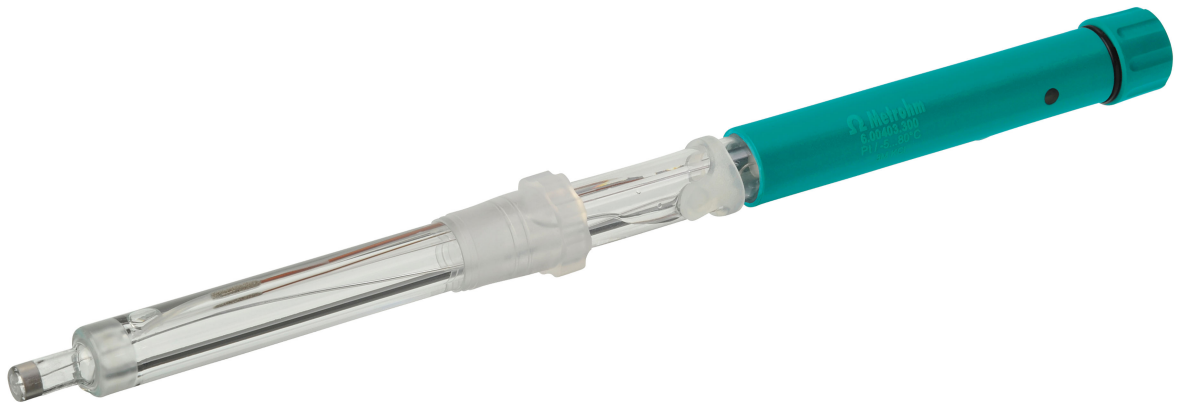

6.00403.300

전극 정보

8.0109.8009KR / 2023-03-31



Metrohm AG
Ionenstrasse
CH-9100 Herisau
Switzerland
+41 71 353 85 85
info@metrohm.com
www.metrohm.com

dPt 링 전극

6.00403.300

전극 정보

8.0109.8009KR /
2023-03-31

본 문서는 저작권법의 보호를 받습니다. 모든 권리는 당사에 있습니다.

본 문서는 신중을 기하여 작성하였습니다. 하지만 오류를 완전히 배제할 수는 없습니다. 만약 본 문서에서 오류를 발견하신다면 위에 명시한 주소로 연락주시기 바랍니다.

면책조항

부적절한 보관, 부적절한 사용 등과 같이 Metrohm의 귀책사유가 아닌 다른 이유로 발생한 결함에 대해서는 품질보증이 제공되지 않음을 분명하게 밝히는 바입니다. 제품에서의 자체 변경(예를 들어 개조 또는 부착)에 대해 제조사는 그로 인해 발생하는 손해 및 후속 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. Metrohm 제품 문서에 명시된 지침 및 매뉴얼의 내용은 반드시 준수해야 합니다. 그렇지 않을 경우 Metrohm에서는 어떠한 보증도 제공하지 않습니다.

목차

1	개요	1
1.1	dPt 링 전극 - 제품 설명	1
1.2	dPt 링 전극 - 개요	1
2	기능 설명	2
2.1	Pt 메탈 전극 - 기능 설명	2
3	공급 및 포장	3
3.1	공급	3
3.2	포장	3
3.3	센서 포장 풀기 및 점검	3
3.4	dPt 링 전극 보관	4
4	설치	5
4.1	dPt 링 전극 전처리	5
4.2	전극 조립	6
5	유지보수	8
5.1	메탈 전극 - 전해질 교환/주입	8
5.2	dPt 링 전극 점검	8
6	장애 제거	9
7	전극 - 폐기	10
8	기술 데이터	11
8.1	설치환경	11
8.2	메탈 전극 - 크기	11
8.3	메탈 전극 - 하우징	11
8.4	메탈 전극 - 포트 사양	11
8.5	dTrodes - 디스플레이 사양	12
8.6	dPt 링 전극 - 측정 사양	12
8.7	dTrode - 아날로그 측정 셋업	12

1 개요

1.1 dPt 링 전극 - 제품 설명

dPt 링 전극은 pH 값 변경에 따른 산화 환원 적정을 위한 결합형 메탈 전극입니다. dPt 링 전극(은)은 OMNIS를 위한 dTrode(디지털 전극)입니다.

1.2 dPt 링 전극 - 개요

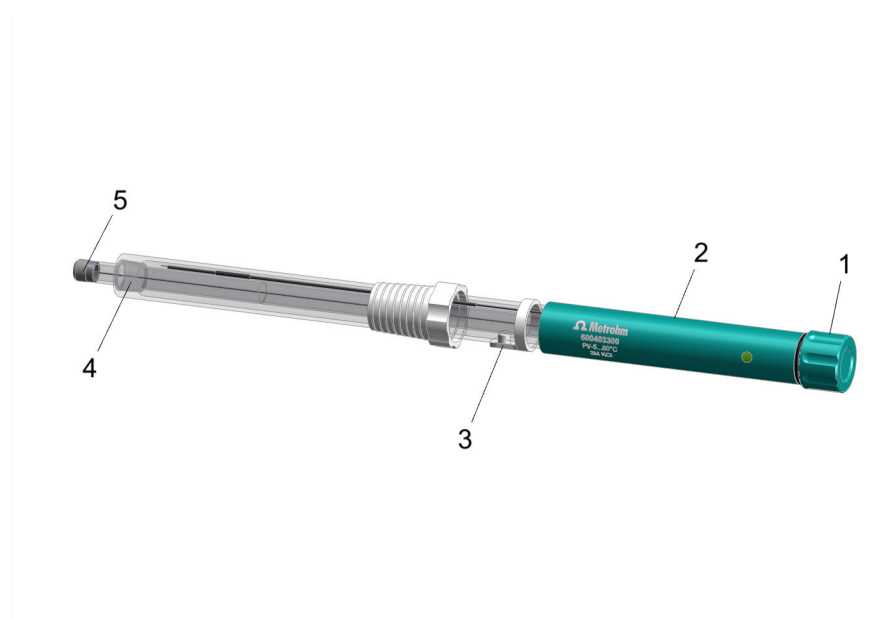


그림 1 dPt 링 전극

1	보호캡	2	전극 헤드
3	주입구	4	다이어프램
5	메탈 링		



2 기능 설명

2.1 Pt 메탈 전극 - 기능 설명

Pt 메탈 전극은 용액에 노출되는 매끈한 메탈 표면을 갖습니다. 산화 환원 활성 이온이 시료 용액에 존재하는 경우 농도에 따른 전위가 Pt 표면에 나타납니다. 이러한 농도에 따른 균형은 해당 전위(갈바니 전위)로 특징 지어집니다.

3 공급 및 포장

3.1 공급

접수한 후 즉시 공급 품목을 점검하십시오:

- 인도증을 근거로 공급 품목의 완전성을 점검하십시오.
- 제품의 손상 여부를 점검하십시오.
- 공급 품목이 완전하지 않거나 또는 손상된 경우에는 지역 Metrohm 담당자에게 연락하십시오.

3.2 포장

제품 및 부속품은 보호 기능이 있는 특수포장에 포장된 상태로 공급됩니다. 이 포장은 제품의 안전한 운반을 보장하기 위해 반드시 보관하십시오. 운반용 고정나사가 존재하는 경우 이것도 보관하고 재사용하십시오.

3.3 센서 포장 풀기 및 점검

주의사항

공구에 과도한 압력을 가하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 센서가 너무 갑자기 분리될 수 있습니다.

- **i** 결함이 있는 센서는 2개월 이내에(배송일 기준) 보증 처리를 위해 송부해야 합니다.

필요한 부속품:

- 고착된 센서를 위한 공구 (함께 공급됨)

1 센서 포장풀기

센서를 저장 용기와 함께 포장재에서 꺼내십시오.



2 저장 용기 제거

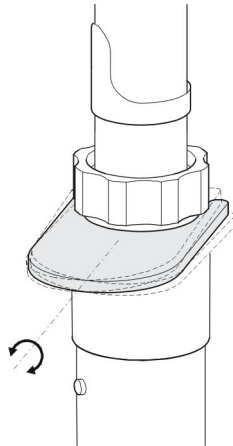


그림 2 저장 용기에서 센서 분리

- 센서가 미끄러지지 않도록 센서와 저장 용기를 한 손으로 잡으십시오.
- 공구를 저장 용기와 조인트 슬리브 사이에 배치하십시오.
- 센서가 분리될 때까지 공구를 **조심스럽게 옆으로** 흔드십시오. 공구를 **앞쪽으로 기울이지 마십시오!**

3 센서 기능 점검

- **센서 전처리:**
dPt 링 전극 전처리 (참조: 5페이지, 4.1 장)
- **전극 점검:**
dPt 링 전극 점검 (참조: 8페이지, 5.2 장)

3.4 dPt 링 전극 보관

전극 헤드를 물, 용매, 분진 및 기계적 영향으로부터 보호하려면 다음과 같이 보관해야 합니다.

- 1** 보호캡(1-1)을 전극 헤드(1-2)에 끼우십시오.
- 2** 전극을 저장 용기에 보관하십시오. 이때 다이어프램(1-4)이 해당 보관 용액에 담겨 있는지 확인하십시오.
i 보관 용액으로 기준전해액 사용을 권장합니다.
- 3** 주입구(1-3)를 막으십시오.
i 전극을 항상 보관 용액에 보관하십시오.

4 설치

4.1 dPt 링 전극 전처리

1 기준전해액 보충

주입구(1-3)의 마개를 열고 필요한 경우 기준전해액을 주입구 높이까지 보충하십시오.

2 전극 청소

- 전극을 증류수로 행구십시오.
- 메탈 링이 심하게 오염된 경우 치약 또는 연마 세트 (6.2802.000)를 사용해 젖은 페이퍼 타월로 청소하십시오.
- 필요한 경우 전극을 적절한 용매로 탈지하십시오.

i 전극은 측정 전에 항상 행귀야 합니다.
 잦은 연마 청소는 권장하지 않습니다.

3 전극 연결

- 보호캡(1-1)을 돌려 빼십시오.
- 케이블 커넥터의 슬롯이 전극 헤드의 러그에 위치하도록 케이블 커넥터를 전극 헤드 위에 배치하십시오.
- 케이블 커넥터의 소켓을 전극 헤드 내부의 플러그에 밀어 넣으십시오.
- 케이블 커넥터의 외부 링을 전극 헤드 위로 미십시오.
 전극 헤드의 가이드 러그가 케이블 커넥터의 홈에 위치하는지 확인하십시오.
- 케이블 커넥터를 전극 헤드에 끝까지 민 후 맞물릴 때까지 외부 링을 돌리십시오.

i 케이블을 제거하려면 먼저 외부 링을 푼 후 케이블 커넥터를 전극 헤드에서 조심스럽게 당겨 빼십시오.
 이때 케이블을 당기지 말고, 케이블의 커넥터를 당기십시오.

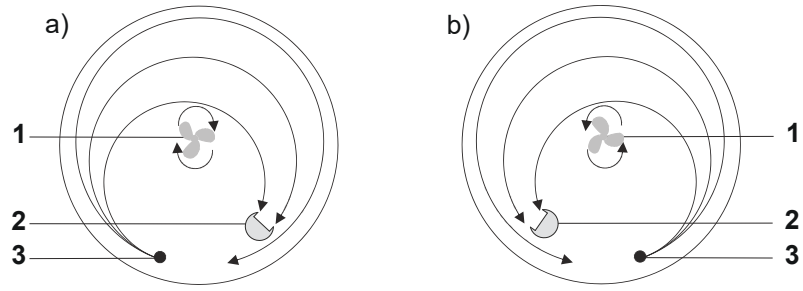


그림 3 적정 중 프로펠러 교반기, 전극, 적정 노즐의 배열 도식. a) 시계 방향의 교반 방향, b) 시계 반대 방향의 교반 방향.

1 프로펠러 교반기

2 전극

3 적정 노즐



5 유지보수

5.1 메탈 전극 - 전해질 교환/주입

- 1 주입구를 여십시오.
- 2 전극을 플라스틱 피펫을 이용해 비우십시오.
- 3 전극 내부를 새 전해질로 세정하십시오.
- 4 전극을 주입구까지 전해질로 채우십시오.
- 5 전극을 바로 사용하지 않는 경우 주입구를 막으십시오.
- 6 전극을 밤새 전해액에 담가 보관하십시오.
그런 다음 전극을 다시 사용할 수 있습니다.

5.2 dPt 링 전극 점검

산화 환원 표준액(6.2306.020)을 통한 전극 점검

- 1 수조에서 산화 환원 표준액의 온도를 20°C로 조절하십시오.
- 2 교반하면서 산화 환원 표준액의 전위를 측정하십시오.
20°C에서 측정 결과가 +250mV (±5mV)인 경우 전극이 성공적으로 점검된 것입니다.
i 측정 결과가 측정 데이터와 일치하지 않는 경우 전극을 청소한 후 테스트를 다시 실행하십시오.

산화 환원 표준액에 대한 추가 측정 데이터는 다음 표에서 확인할 수 있습니다.


표 1 온도에 따른 산화 환원 표준액(6.2306.020)의 측정 데이터

온도(°C)	10	20	25	30	40	50	60	70
mV ± 5	+ 265	+ 250	+ 243	+ 236	+ 221	+ 207	+ 183	+ 178

6 장애 제거

문제	원인	조치
느린 조정 동작	그리스 및 오일은 전극에서 절연 층을 발생시킵니다.	용매를 이용해 전극을 청소합니다.
	약한 산화환원 완충용액을 사용하는 경우 이온(예를 들어 산화물)이 전극 표면에서 흡수될 수 있습니다.	연마성, 산화성(산화 용액의 경우) 또는 환원성(환원 용액의 경우) 전처리.
오류 잠재성	그리스 및 오일은 전극에서 절연 층을 발생시킵니다.	용매를 이용해 전극을 청소합니다.

7 전극 - 폐기



본 제품은 유럽 지침, WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment(폐 전기전자제품 처리지침))을 준수합니다.

폐장비의 올바른 폐기는 환경 오염 및 인체 유해성을 방지하기 위해 반드시 필요한 조치입니다.

전극 폐기 시 다음과 같이 진행하십시오.

1 전해질 비우기

전해질을 플라스틱 피펫을 이용해 전극에서 제거하십시오.

2 전해질 폐기

전해질을 현지 규정에 따라 폐기하십시오.

3 전극 폐기

전극을 폐전자제품 재활용 시설로 보내십시오.

폐제품의 올바른 폐기 방법은 지역 해당 관청, 폐기물 처리 서비스 또는 해당 딜러에 문의하시기 바랍니다.

8 기술 데이터

8.1 설치환경

공칭 작동범위	+5~+45°C	최대 80% 상대 습도, 비응축
보관	+5~+45°C	

8.2 메탈 전극 - 크기

사이즈	
막대 직경	12mm
최대 장착 길이	125mm

8.3 메탈 전극 - 하우징


재료	
막대 재료	유리

8.4 메탈 전극 - 포트 사양

포트	Metrohm 플러그인 헤 드 Q
----	-----------------------

측정 정확도

모든 측정 범위에 있어 유효, 센서 결함 없음, 기준 조건, 측정 주기 100ms에서

 센서에 구성된 아날로그 측정 회로의 측정 접점에서 유효합니다. 그 연결부는 기본 제공 상태에서는 액세스할 수 없습니다.