

Application Note AN-V-237

無電解ニッケルめっき浴中の鉛 (Pb) 安定剤の定量

滴下ヒスマス電極を用いた広い濃度範囲における鉛 (Pb) の直接定量

無電解ニッケルめっきフロセスは、耐摩耗性および耐食性に優れた低成本のソリューションです。このフロセスでは、大型または複雑な基材に対しても均一な膜厚めっきを施すことが可能です。フリント基板の製造においては、ENIG(無電解ニッケル・浸漬金)およびENEPIG(無電解ニッケル・無電解ハラシウム・浸漬金)フロセスの効率か、無電解ニッケルめっき浴の正確な組成に大きく依存します。鉛などの浴中安定剤の濃度をモニタリングすることは、規

格に適合した高品質なめっき皮膜を確保する上で極めて重要です。無電解ニッケル浴中の鉛安定剤の典型的な濃度は、約1 mg/L Pbです。

水銀を使用しないヒスマストロッフ電極は、重金属のホルタンメトリー分析における無毒性の手法を提供します。この環境に配慮したセンサーは、アノードストリッピングホルタンメトリー(ASV)を用いて、無電解ニッケルめっき浴中の鉛の定量を可能にします。

サンプル

無電解ニッケルめっき浴液

測定

測定容器に、水、ニッケルめっき浴液サンフル、および電解溶液を加えます。鉛の定量は、図1に示す884 Professional VAを用い、表1に記載されたハラメーターに従って実施します。濃度は、鉛標準添加溶液を2回添加する標準添加法により求めます。滴下ヒスマス電極は、最初の測定の前に電気化学的に活性化させます。



図 1. 884 Professional VA : ポルタントメトリー分析用の全自动分析システム例

表 1. ハラメーター

ハラメーター	設計
モード	DP – Differential Pulse
析出電位	-0.65 V
析出時間	60 s
開始電位	-0.65 V
終了電位	-0.3 V
鉛 (Pb) のピーク電位	-0.5 V

電極

- 作用電極: 滴下ヒスマス電極
- 参照電極: Ag/AgCl/KCl (3 mol/L)

- 補助電極: Glassy carbon rod

測定結果

析出時間60秒における検出下限(LOD)は0.1 mg/L(Pb)です。この優れた感度は、無電解ニッケルめっき浴中における鉛安定剤の通常濃度をモニタリングするには十分です。

この手法は、自動化システムやプロセス分析装置に最適であり、大量のサンプルの鉛(Pb)を完全自動で測定することができます。

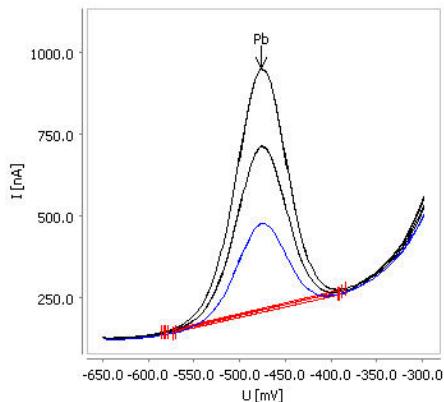


図2. 鉛(Pb)濃度1.2 mg/Lの無電解ニッケルめっき浴液サンプル(サンプル量: 50 μL)中の鉛の定量

表2. 測定結果

サンプル	Pb (mg/L)
鉛(Pb) 1.2 mg/L 無電解ニッケルめっき浴液	1.16

参考文献

1. Application Bulletin 438: Determination of cadmium and lead in water samples by anodic stripping voltammetry with a Bi drop electrode.

CONTACT

メトロームジャパン株式会社
143-0006 東京都大田区平和島6-1-1
null 東京流通センター アネックス9階

metrohm.jp@metrohm.jp

装置構成



(MME) 884 Professional VA manual

マルチモード電極 (MME) のための 884 Professional VA manual は、マルチモード電極 pro、scTRACE Gold または滴下ヒスマス電極を使用したホルタングルーフィーおよびホーラロクラフィーによるハイエント微量分析へのエントリーレベル装置です。高性能のホテンショスタット/カルハノスタットと、非常に柔軟な viva ソフトウェアとのコンビネーションにおける熟練した Metrohm の電極技術が重金属の測定に新たな展望を開きます。性能が認証されたキャリフレータの付いたホテンショスタットは、各測定前に自動的に新たに調整を行い、可能な限り高い精度を保証します。

この装置と組み合わせることで、例えは CVS (サイクリックホルタングルーフィーストリッピング)、CPVS (サイクリックハルスホルタングルーフィーストリッピング)、CP (クロノホテンショメトリー) による電気めっき浴内の有機添加物の測定など、回転ディスク電極による測定を実施することも可能となります。交換可能な測定ヘッドにより、異なる電極を持つ様々なアプリケーション間の迅速な交換が可能となります。

コントロール、データ処理および評価のためにソフトウェア viva が必要となります。

884 Professional VA manual MME仕様は、多数の付属品およびマルチモード電極 pro のための測定ヘッドを付属して納品されます。電極セットおよび viva ライセンスは別途ご注文ください。