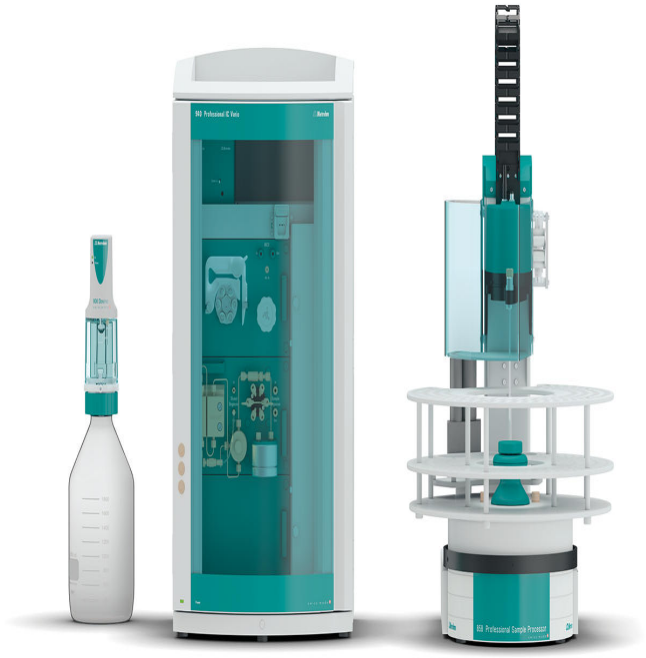


«ProfIC Vario 4 Anion» – Metrohmのインライン希釈を備えたProfessional IC Vario システム

ProfIC-Vario-04-Anion

Metrohmのインテリジェントインライン希釈、連続サプレッション、**電気伝導度検出**を備えたProfessional IC Vario システムは、濃縮溶液中の陰イオンまたは陽イオンを完全自動測定することができます。

典型的な使用領域:

– イオン濃度の高いサンプル
– あらゆる分野におけるサンプル

概略図

納品範囲 ProfIC-Vario-04-Anion

Order Number	説明	数量
2.940.1500 	**940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP** 940 プロフェッショナル IC Vario ONE/SeS/PP は**連続サプレッション**とサプレッサー再生のための**ペリスタリックポンプ**を備えたインテリジェントIC装置です。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することができます。 典型的な使用領域: - 連続サプレッションおよび電気電導度検出器による陰イオンの測定 - 陰イオンのトレース分析 - 陰イオンのオンラインモニタリング	1 PCS
2.850.9010 	**IC Conductivity Detector** インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。 優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。	1 PCS
2.858.0020 	**858 Professional Sample Processor – Pump** 858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ - ポンプは、500 µLから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプまたは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。	1 PCS

2.741.0010

741 Magnetic Stirrer 1 PCS



サンプルチェンジャー用Magnetic Stirrer。
Magnetic　Stirrerは、サンプルラックの下に配置されています。

2.800.0010

800 Dosino（ケーブル：1.5 m） 1 PCS



800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。

6.5330.120

ICアクセサリー: インライン希釈 1 PCS



インライン希釈のための付属品セット。858プロフェッショナルサンプルプロセッサ、800　ドジーノ電動ビュレット、741 マグネチックスターラとの併用に。

オプションアクセサリー

6.2041.760
Sample rack 54 x 11 mL + 1 x 300 mL



6.2041.440
サンプルラック、148 x 11 mL および 3 x 300 mL、(ポリ塩化ビニル製)



148　個のサンプル容器および3個のリンスボトルに適した　858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用することができます:　6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。
合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.2743.040
PP バイアル、2.5 mL、2000 個



2.5 mL。2000 個。IC Sample Processors 用。
ICサンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および梱包は、無菌室およびクリーンルーム（DIN　ISO 14644に準拠したクリーンルームクラス　7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

6.2743.050
サンプル容器 11 mL



2000 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。
IC　サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

6.2743.070
Stopper with perforation



6.2842.000
MSM-HC Rotor A



6.2844.000
MSM-LC Rotor A



6.2832.000
MSM Rotor A



6.2842.020
アダプタスリーブ、MSM

アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。



2.941.0010
941 Eluent Production Module

941 溶離液生成モジュール により、溶離液の自動製造が可能となります。このモジュールは、手動で介入しなくても連続して処理することを可能にし、安定した保持時間を保証します。このモジュールはあらゆるメトロームのICデバイスと接続させることができ、MagIC Netによって制御されます。



6.2842.200
MSM-HC Rotor C



6.6059.422
MagIC Net 4.2 Professional: 1ライセンス

6.6059.423
MagIC Net 4.2 Multi: 3 ライセンス
