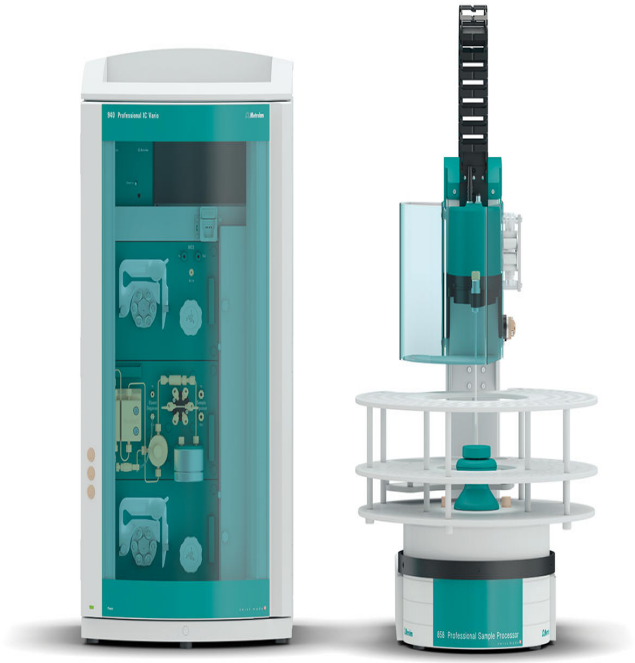


«ProfIC Vario 10 Anion» – インライン中和を備えた Professional IC Vario システム

ProfIC-Vario-10-Anion

Metrohmのインライン中和、連続サプレッション、電気伝導度検出を備えた Professional IC Vario システムは、強アルカリ性、強酸性の、または金属汚染されたマトリックス中の陰イオンを測定することができます。

典型的な使用領域:

– アルカリ液および酸における微量分析
– 電気めっき工業からのスターター物質
– 電気めっき浴槽内の不純物

概略図

納品範囲 ProfIC-Vario-10-Anion


Order Number	説明	数量
2.940.1530 	**940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP/Prep 3** 940プロフェッショナル IC Vario ONE/SeS/PP/Prep 3は、**インライン中和化**または**インライン陽イオン除去**などといったメトロームインラインサンプル前処理のコンビネーションによる、**連続サプレッション**およびサプレッサー再生のための**ペリスタリックポンプ**を備えたインテリジェントIC装置です。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することができます。 典型的な使用領域: - インライン中和化後の連続サプレッションによる陰イオン分析 - インライン中和化とその後のMiPCT-MEを伴うオンライントレース分析 - 電気めっき浴など、遷移金属濃度の高いサンプル中の陽イオン除去後の陰イオン分析	1 PCS
2.850.9010 	**IC Conductivity Detector** インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。 優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。	1 PCS

6.2835.000 **SPM Rotor A** 1 PCS



2.858.0030 **858 Professional Sample Processor – Pump – Injector** 1 PCS

858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ ： ポンプ – インジェクター は、500 µLから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプもしくは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。更にサンプル前処理では、六方向注入バルブの使用が可能です。



6.1602.150 **Bottle attachment / GL 45 - 3 x UNF 10/32** 1 PCS



6.1608.070 **Eluent bottle / 2 L / GL 45** 1 PCS



6.1825.230	**PEEK sample loop 10 µL**	1 PCS



オプションアクセサリー

6.2041.760
Sample rack 54 x 11 mL + 1 x 300 mL



6.2041.440
サンプルラック、148 x 11 mL および 3 x 300 mL、(ポリ塩化ビニル製)



148　個のサンプル容器および3個のリンスボトルに適した　858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用することができます:　6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。
合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.2743.040
PP バイアル、2.5 mL、2000 個



2.5 mL。2000 個。IC Sample Processors 用。
ICサンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および梱包は、無菌室およびクリーンルーム（DIN　ISO 14644に準拠したクリーンルームクラス　7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

6.2743.050
サンプル容器 11 mL



2000 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。
IC　サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

6.2743.070
Stopper with perforation



6.2842.000
MSM-HC Rotor A



6.2844.000
MSM-LC Rotor A



6.2832.000
MSM Rotor A



6.2842.020
アダプタスリーブ、MSM

アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。



2.941.0010
941 Eluent Production Module

941 溶離液生成モジュール により、溶離液の自動製造が可能となります。このモジュールは、手動で介入しなくても連続して処理することを可能にし、安定した保持時間を保証します。このモジュールはあらゆるメトロームのICデバイスと接続させることができ、MagIC Netによって制御されます。



6.5330.130
ICアクセサリー: リキッドハンドリングステーション(左)

プロフェッショナルサンプルプロセッサーのリキッドハンドリングステーションの設置のための付属品セット。洗浄水の供給はペリスタリックポンプもしくはドジーノ電動ビュレットによって行われます。



2.800.0010
800 Dosino（ケーブル：1.5 m）

800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。



6.2744.080
M6 thread / UNF 10/32 adapter



6.3032.150
807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.2842.200
MSM-HC Rotor C



6.6059.422
MagIC Net 4.2 Professional: 1ライセンス



6.6059.423
MagIC Net 4.2 Multi: 3 ライセンス