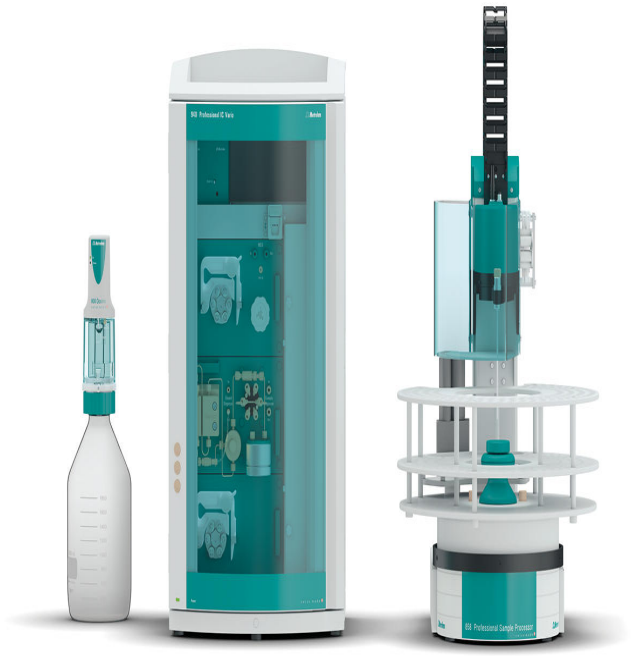


«ProfIC Vario 7 Anion» – 带英蓝稀释和英蓝渗析的 Professional IC Vario 系统

ProfIC-Vario-07-Anion

此 Professional IC Vario 系统（带**万通英蓝稀释**、**英蓝渗析**、**序列抑制法**和**电导检测**）可实现高浓度中以及复杂基质中的阴离子全自动测定。

典型的应用范围：

– 工艺水、洗涤水和废水
– 含有样品
– 用于生物柴油分析的英蓝萃取

示意图

Scope of delivery ProfIC-Vario-07-Anion

Order Number	Description	Quantity
2.940.1510	**940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP/Prep 1** 940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP/Prep 1 是智能型离子色谱仪器，带有**序列抑制**和**蠕动泵**用于抑制器再生，与万通英蓝样品前处理以及**英蓝超滤**或**英蓝渗析**组合使用。该仪器可使用各种分离和检测方法。 典型的应用范围： – 阴离子或阳离子测定，英蓝超滤或英蓝渗析之后序列抑制法	1 PCS
2.850.9010	**IC Conductivity Detector** 用于智能型离子色谱仪的紧凑智能型高性能电导检测器。不凡的温度稳定性，受保护的检测器端子板内的整个信号处理过程以及新一代的 DSP（数字式信号处理）均能确保测量的准确性。归功于动态工作范围，无需进行范围变更（也不是自动进行）。	1 PCS
2.858.0020	**858 Professional Sample Processor – Pump** 858 Professional Sample Processor – Pump 可处理体积在 500 µL 至 500 mL 之间的样品。进行样品转移时，既可以使用内置的双向双通道蠕动泵、也可通过 800 Dosino 来进行。	1 PCS

2.741.0010

741 Magnetic Stirrer 1 PCS

自动进样器的磁力搅拌器。
该磁力搅拌器位于样品架下方。



2.800.0010

800 Dosino (电缆 1.5 m) 1 PCS

800 Dosino 是一种带有智能型配液单元读写硬件的驱动装置。配有固定安装的电缆（长度 1.5 m）。



6.5330.120

离子色谱装备：英蓝稀释 1 PCS

英蓝稀释的附加组。与 858 Professional Sample Processor、800 Dosino 和 741 Magnetic Stirrer 磁力搅拌器一同使用。



6.5330.200

离子色谱装备：“低容量”英蓝渗析 1 PCS

用于快速英蓝渗析的附件组。与 858 Professional Sample Processor 和一台附加的 2 通道蠕动泵一同使用。



Optional accessories

6.2041.760
样品架 54 x 11 mL + 1 x 300 mL



较小直径的样品盘，用于排成两排的 54 x 11 mL 样品容器及附加的 1 x 300 mL 样品瓶

6.2041.440
样品架，148 x 11 mL 和 3 x 300 mL，（聚氯乙烯）



与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL 适配的样品架，用于 148 个样品容器和 3 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶：6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。
塑料：聚氯乙烯 (PVC)

6.2743.050
样品容器 11 mL



2000 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。

6.2743.070
塞子，其上有穿孔

2000只。 用于IC样品处理器



6.2842.000
MSM-HC 马达 A

适用于所有带 MSM-HC（高容量万通抑制器模块）的离子色谱仪的抑制器马达



6.2844.000
MSM-LC 马达 A

抑制器马达，与 2 mm 分离柱一起使用



6.2832.000
MSM 转子 A

抑制器转子，用于所有带MSM的IC仪器。



6.2842.020
适配器套管，MSM



可在适配器套管的帮助下将 MSM Rotor A 和 MSM-LC Rotor A 安装在转子外壳中。

2.941.0010
941 Eluent Production Module



941 Eluent Production Module 可自动制备淋洗液。 能够在无需人工干涉的情况下进行持续地不间断工作，并确保稳定的保留时间。 可与所有的万通离子色谱仪组合应用，并由 MagIC Net 进行操控。

2.800.0010
800 Dosino (电缆 1.5 m)



800 Dosino 是一种带有智能型配液单元读写硬件的驱动装置。配有固定安装的电缆（长度 1.5 m）。

6.3032.150
807 Dosing Unit 5 mL



807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，5 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。

6.2744.080
螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器



带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。

6.2842.200
MSM-HC 马达 C



适用于所有带 MSM-HC 驱动装置（高容量万通抑制器模块）的离子色谱仪的抑制器马达，用于阳离子抑制。

6.6059.422
MagIC Net 4.2
Professional：1 份许可证

用于控制所有智能型 Professional IC 系统、Compact IC 仪器及其外部设备，所有检测器和各种 Autosampler、800 Dosino、771 Compact Interface 的 Metrohm 专业色谱法软件。该软件可用于离子色谱分析的控制、数据采集、数据评估和监控，以及生成报告。
图形用户界面，用于常规操作、大量数据库程序、方法开发、配置和手动系统控制；灵活的用户管理、易用的数据库操作、大量数据输出功能、可个性化配置的报告生成器、控制和监控全部系统元件和色谱分析结果。
MagIC Net Professional 符合 FDA 准则 21 CFR 第 11 部分以及 GLP。
MagIC Net 提供 15 种对话框语言：德语、英语、中文、繁体中文、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、保加利亚语、捷克语、匈牙利语、日语、韩语、俄语、斯洛伐克语
该版本对图形用户界面进行了更新，还有话了 4K 监视器上用户界面的缩放和清晰度。
1 份许可证
将在一个 U 盘上提供安装文件和文献。

6.6059.423

MagIC Net 4.2 Multi：3 份许可证

用于控制所有智能型 Professional IC 系统、Compact IC 仪器及其外部设备，所有检测器和各种 Autosampler、800 Dosino、771 Compact Interface 并具有客户端/服务器能力的 Metrohm 色谱法软件。
该软件可用于离子色谱分析的控制、数据采集、数据评估和监控，以及生成报告。
数据和方法集中保存在服务器上。

图形用户界面，用于常规操作、大量数据库程序、方法开发、配置和手动系统控制；灵活的用户管理、易用的数据库操作、大量数据输出功能、可个性化配置的报告生成器、控制和监控全部系统元件和色谱分析结果。
MagIC Net Multi 符合 FDA 准则 21 CFR 第 11 部分以及 GLP。
MagIC Net 提供 15 种对话框语言：德语、英语、中文、繁体中文、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、保加利亚语、捷克语、匈牙利语、日语、韩语、俄语、斯洛伐克语
该版本对图形用户界面进行了更新，还有话了 4K 监视器上用户界面的缩放和清晰度。
公司内部网络外带服务器的客户端服务器系统的性能也得到了优化。
客户端服务器版本带 3 份许可证