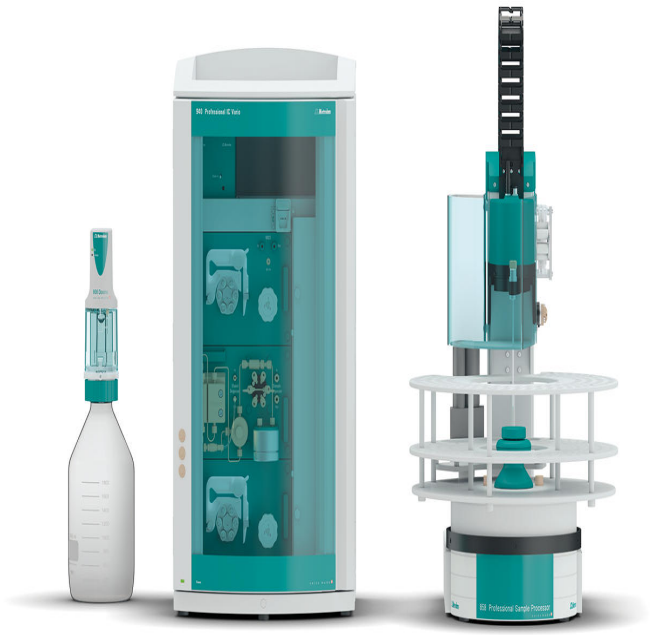


«ProfIC Vario 11 Anion» – 带英蓝中和、智能浓缩技术和英蓝基质消除的 Professional IC Vario 系统

ProfIC-Vario-11-Anion

此 Professional IC Vario 系统（带**万通英蓝中和**、**万通智能英蓝浓缩技术**和**英蓝基质消除**以及**序列抑制法**和**电导率检测**）可实现复杂基质中的阴离子分析，直至最低 mg/L 的超痕量范围。

典型的应用领域：

– 浓缩的碱和酸痕量分析
– 用于核电厂的基质中的超痕量分析，如氢氧化锂/硼酸

示意图

Scope of delivery ProfIC-Vario-11-Anion

Order Number	Description	Quantity
2.940.1530	**940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP/Prep 3** 940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP/Prep 3 是智能型 IC 仪器，带有**序列抑制**，带**蠕动泵**用于抑制器再生，与万通英蓝样品前处理以及**英蓝中和**或**英蓝阳离子消除**组合使用。 该仪器可使用各种分离和检测方法。 典型的应用范围： – 序列抑制法阴离子测定，英蓝中和 – 在线痕量分析，带英蓝中和以及之后的 MiPCT-ME – 在过渡金属浓度较高的样品（例如电镀池）中消除阳离子后进行阴离子分析	1 PCS
2.850.9010	**IC Conductivity Detector** 用于智能型离子色谱仪的紧凑智能型高性能电导检测器。不凡的温度稳定性，受保护的检测器端子板内的整个信号处理过程以及新一代的 DSP（数字式信号处理）均能确保测量的准确性。归功于动态工作范围，无需进行范围变更（也不是自动进行）。	1 PCS
2.858.0030	**858 Professional Sample Processor – Pump – Injector** 858 Professional Sample Processor – Pump – Injector 可处理体积在 500 µL 至 500 mL 之间的样品。进行样品转移时，既可以使用内置的双向双通道蠕动泵、也可通过 800 Dosino 来进行。此外还有一台用于样品准备的六路进样阀可供使用。	1 PCS

2.800.0010

800 Dosino (电缆 1.5 m) 1 PCS

800 Dosino 是一种带有智能型配液单元读写硬件的驱动装置。配有固定安装的电缆（长度 1.5 m）。



6.5330.140

离子色谱装备：MiPCT 1 PCS

英蓝浓缩（MiPCT）的附件组，包括左侧 LQH。



6.1808.090

螺纹转接器，M8/M6 1 PCS

外螺纹M8，内螺纹M6，例如，用于将6.2418.XXX空气管安装在679 Rancimat的6.1429.030反应杯中。



6.1014.200

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0（捕获柱） 1 PCS

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 捕获柱用于清除水溶剂中的离子杂质，即阳离子和阴离子杂质。建议将其用于清洁输送水，尤其用于 «MISP»，即 «Metrohm Inline Sample Preparation»（英蓝技术）。通过使用 Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 保护柱可大幅降低输送水对系统空白值的影响。



6.2832.000

MSM 转子 A

1 PCS



抑制器转子，用于所有带MSM的IC仪器。

6.2842.020

适配器套管，MSM

1 PCS



可在适配器套管的帮助下将 MSM Rotor A 和 MSM-LC Rotor A 安装在转子外壳中。

Optional accessories

6.9920.191
样品架，35 x 60 mL 和 3 x 250 mL，（聚氯乙烯）




与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL 适配的样品架，用于 35 个样品容器和 3 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶：6.1608.100, 60 mL und 250 mL Nalgene FEP 容器。
塑料：聚氯乙烯 (PVC)

6.1608.100
PE 瓶 50 mL



用于扩展模块 Liquid Handling 的瓶子。

6.2820.000
铝箔



80 mm 直径的 1000 个圆片。铝箔厚度：0.010 mm。与铝箔支架 6.2037.040 样品杯一起组成 6.1432.210，与铝箔支架 6.2037.080 一起组成样品杯 6.1459.300。

6.2842.000
MSM-HC 马达 A

适用于所有带 MSM-HC（高容量万通抑制器模块）的离子色谱仪的抑制器马达



6.2844.000
MSM-LC 马达 A

抑制器马达，与 2 mm 分离柱一起使用



2.941.0010
941 Eluent Production Module

941 Eluent Production Module 可自动制备淋洗液。 能够在无需人工干涉的情况下进行持续地不间断工作，并确保稳定的保留时间。 可与所有的万通离子色谱仪组合应用，并由 MagIC Net 进行操控。



2.800.0010
800 Dosino (电缆 1.5 m)

800 Dosino 是一种带有智能型配液单元读写硬件的驱动装置。配有固定安装的电缆（长度 1.5 m）。



6.2744.080
螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器



带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。

6.3032.150
807 Dosing Unit 5 mL



807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，5 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。

6.2842.200
MSM-HC 马达 C



适用于所有带 MSM-HC 驱动装置（高容量万通抑制器模块）的离子色谱仪的抑制器马达，用于阳离子抑制。

6.6059.422
MagIC Net 4.2
Professional：1 份许可证

用于控制所有智能型 Professional IC 系统、Compact IC 仪器及其外部设备，所有检测器和各种 Autosampler、800 Dosino、771 Compact Interface 的 Metrohm 专业色谱法软件。该软件可用于离子色谱分析的控制、数据采集、数据评估和监控，以及生成报告。
图形用户界面，用于常规操作、大量数据库程序、方法开发、配置和手动系统控制；灵活的用户管理、易用的数据库操作、大量数据输出功能、可个性化配置的报告生成器、控制和监控全部系统元件和色谱分析结果。
MagIC Net Professional 符合 FDA 准则 21 CFR 第 11 部分以及 GLP。
MagIC Net 提供 15 种对话框语言：德语、英语、中文、繁体中文、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、保加利亚语、捷克语、匈牙利语、日语、韩语、俄语、斯洛伐克语
该版本对图形用户界面进行了更新，还有话了 4K 监视器上用户界面的缩放和清晰度。
1 份许可证
将在一个 U 盘上提供安装文件和文献。

6.6059.423
MagIC Net 4.2 Multi：3 份许可证

用于控制所有智能型 Professional IC 系统、Compact IC 仪器及其外部设备，所有检测器和各种 Autosampler、800 Dosino、771 Compact Interface 并具有客户端/服务器能力的 Metrohm 色谱法软件。
该软件可用于离子色谱分析的控制、数据采集、数据评估和监控，以及生成报告。
数据和方法集中保存在服务器上。

图形用户界面，用于常规操作、大量数据库程序、方法开发、配置和手动系统控制；灵活的用户管理、易用的数据库操作、大量数据输出功能、可个性化配置的报告生成器、控制和监控全部系统元件和色谱分析结果。
MagIC Net Multi 符合 FDA 准则 21 CFR 第 11 部分以及 GLP。
MagIC Net 提供 15 种对话框语言：德语、英语、中文、繁体中文、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、保加利亚语、捷克语、匈牙利语、日语、韩语、俄语、斯洛伐克语
该版本对图形用户界面进行了更新，还有话了 4K 监视器上用户界面的缩放和清晰度。
公司内部网络外带服务器的客户端服务器系统的性能也得到了优化。
客户端服务器版本带 3 份许可证
